


IKA

designed for scientists

CN

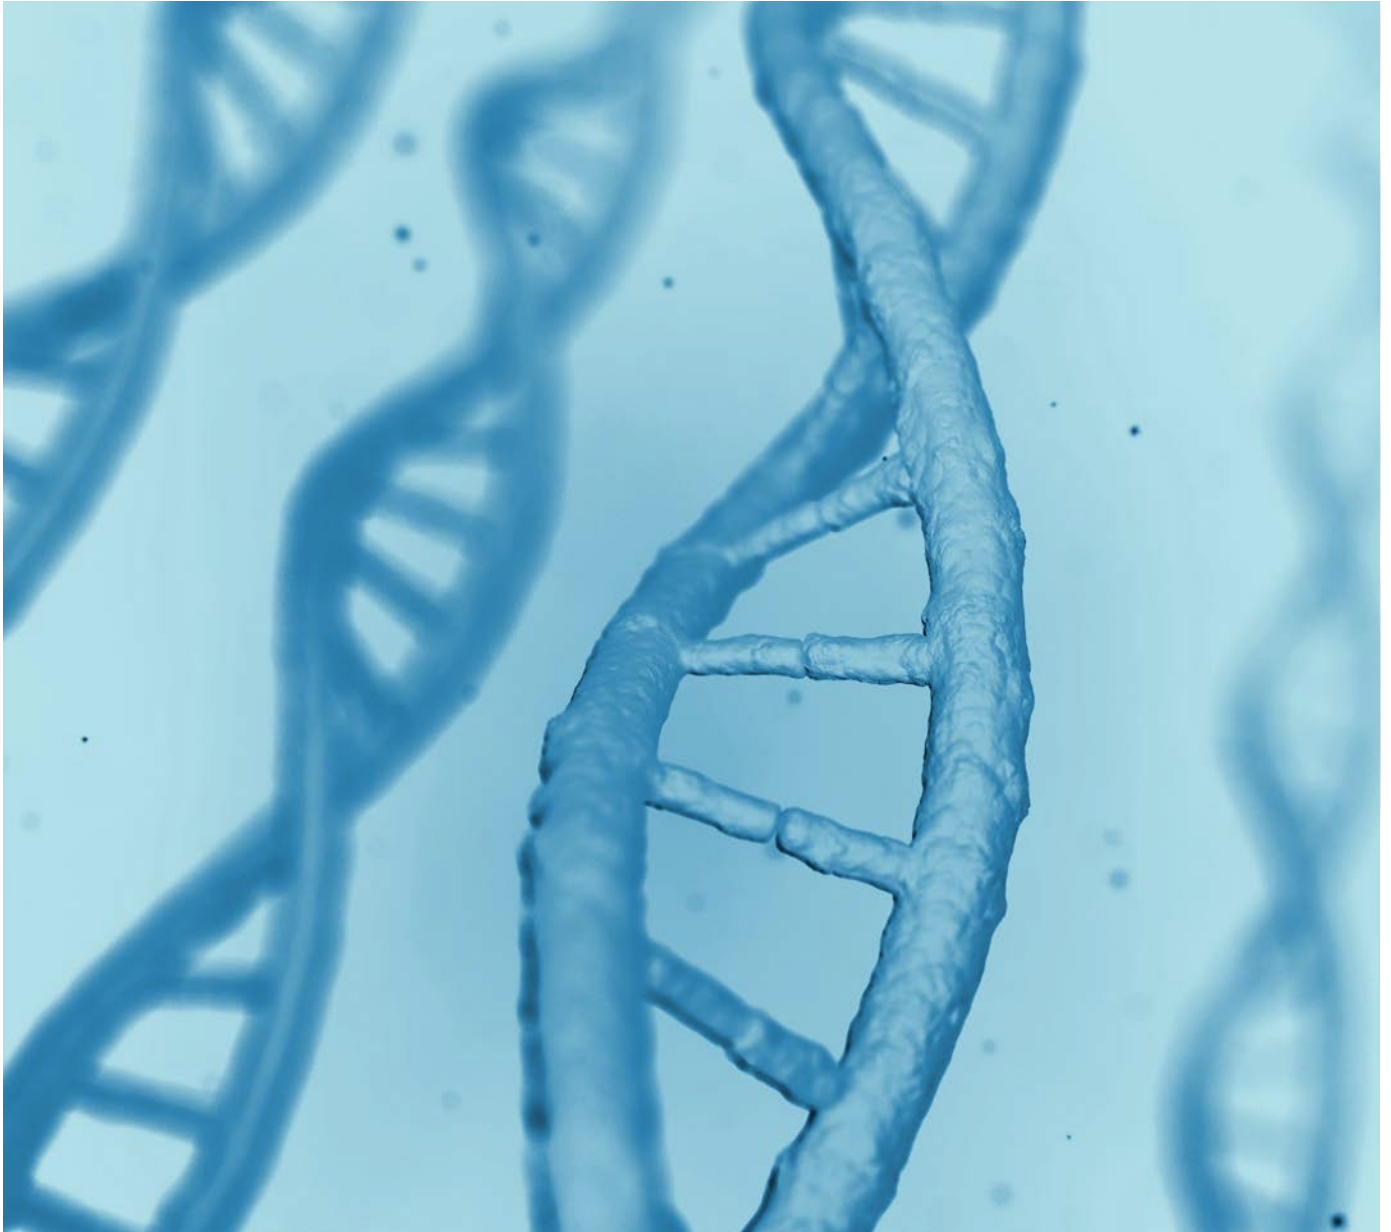

通过 RT-PCR 方法检测 COVID-19 病毒
DNA / RNA 提取纯化的相关产品推荐

通过 RT-PCR 方法检测 COVID-19 病毒

DNA / RNA 提取纯化的相关产品推荐

> 1 | 样品准备



IKA PETTE vario

移液器及吸头

IKA PETTE vario 0.5 – 10 µl	0020011211
IKA PETTE vario 100 – 1000 µl	0020011216
IKA Tip xs box (DNA/RNase free)	0020017820
IKA Tip s box (DNA/RNase free)	0020017824

DNA/RNase-free
滤芯吸头



Roller 6 digital

混匀器

Roller 6 basic	0004010000
Roller 6 digital	0004011000
Roller 10 basic	0004012000
Roller 10 digital	0004013000
Vortex 3 圆周振荡, 高速涡旋	0003340025

Roller 10 basic



Vortex 3



> 2 | 样品裂解

适用于小量样品的
圆周振荡混匀



Matrix Orbital Δ



移液器和吸头

IKA PETTE vario 0.5 – 10 µl	0020011211
IKA PETTE vario 100 – 1000 µl	0020011216
IKA Tip xs box (DNA/RNase free)	0020017820
IKA Tip s box (DNA/RNase free)	0020017824

恒温混匀仪

Matrix Orbital Δ F1.5	0020025654
Matrix Orbital Δ F2.0	0020025674

> 3 | 纯化和提取

分离操作的理想设备



IKA mini G



IKA G-L

离心机和转子


IKA G-L	0030001174
IKA G-L, 2 ml rotor set	0030001333
IKA G-L, PCR Set	0030001345
IKA G-L, Adapter PCR tube	0030001346
IKA mini G	0003958000

更多选项

德国 IKA 可同时提供以下设备以供您的实验需要, 它们可连同以上选型, 成为 DNA / RNA 纯化和提取操作所需的完整方案:



Dry Block Heater 3
干浴器
订货号: 0004025325

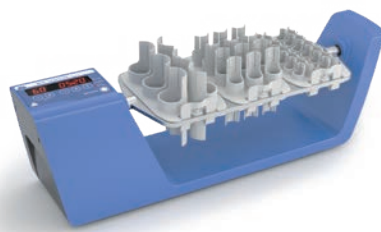

Trayster digital
翻转式混匀器
订货号: 0004006000



Loopster basic
转盘式混匀器
订货号: 0004015000

更多配件



LINEA Pipette Rack

用于固定移液器的专用支架, 以便在频繁使用时方便操作。
订货号: 0020018987



VG 3.3 通用底座

通用底座, 用于夹持直径 150 mm 的 Vortex 3 垫片。
订货号: 0003342400



Pipette Calibration Software

IKA 提供一个用户友好的移液器校准软件, 可用于计划、执行、记录所有移液器校准测试。
订货号: 0020022141

更多选配件
请参阅
IKA 官方网站:
www.ika.com

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue